

Fecha de entrada en vigencia: 11 de julio de 2018
Fecha de emisión del Alcance Técnico de
Acreditación: 07 de febrero de 2020
Fecha de renovación: N/A



ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIÓN

Alcance Técnico de Acreditación No. 001/LC-001

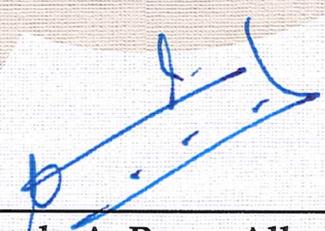
LABORATORIO DE TEMPERATURA

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

Dirección: Paseo Presidente Vicini Burgos #60 Gazcue, Distrito Nacional, Santo Domingo, Rep. Dom.
Norma de referencia: NORDOM ISO/IEC 17025:2005

| Área | Magnitud | Servicio de Calibración | | Rango de Medición/ Otros Parámetros | Capacidad de Calibración y Medición (CCM)* | Instalaciones |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--|---|--|---------------|
| | | Instrumento o Sistema de Medición | Método o Norma/ Documento de Referencia | | | |
| TEMPERATURA | Temperatura | Termómetro de Indicación Digital | PR-TEM-001/ Comparación | (-10 a 130) °C | 0,04°C | Fijas |
| TEMPERATURA | Temperatura | Termómetro de líquido en vidrio | PR-TEM-002/ Comparación | (-10 a 80) °C | 0,04°C | Fijas |
| TEMPERATURA | Temperatura | Termómetro de Resistencia | PR-TEM-003/ Comparación | (-10 a 130) °C | 0,023°C | Fijas |

La incertidumbre expresada con un factor de cobertura $k=2$, corresponde aproximadamente al 95 % de nivel de confianza, según la GUM.


Ing. Fernando A. Reyes Alba
Director Ejecutivo

La acreditación está condicionada al cumplimiento continuo por parte del OEC con los requisitos de acreditación, por lo que la vigencia de la acreditación debe ser consultada en www.odac.gob.do.